クーデック® A BRAND OF DAIKEN MEDICAL COOPDECH

**[注意事項]**

1. 本製品は滅菌済みディスポーザブル製品です。再使用はできません。
2. 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する薬液、油性成分を含む薬液、界面活性剤又はエタノール等の溶解補助剤を含む薬液の投与時に使用しないでください。薬液によりメスコネクターにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性があります。特に全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性があります。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となります。
3. 添付文書及び取扱説明書を必ずお読みになり、本製品をよくご理解した上で使用してください。
4. 設定する流量に関しては、対象部位、患者の体格と年齢、使用者の経験、技法を勘案して行ってください。
5. 包装が破損しているもの、その他汚染されている疑いのあるものは使用しないでください。
6. 使用前に本製品に傷や亀裂が無いか、著しい劣化が無いかを点検してください。
7. 接続部は締め付け器具等で過度に締めすぎないでください。ひび割れが生じて薬液が漏れる恐れがあります。
8. 薬液の充填時はガラス片等の異物の混入にご注意ください。注入ポートからの液漏れの恐れがあります。
9. 本製品を使用する前に、カテーテル、チューブ、コネクターの接続状態やチューブの折れ等の点検を行い、正常に動作することを確認してください。また、患者に留置するカテーテルの再点検を行ってください。
10. 高い粘性又はエマルジョン状の薬液は使用しないでください。流量制御部の細管やエアベントフィルターの目詰まりにより閉塞の原因になることがあります。
11. 投与する薬液のお取り扱いは、該当する医薬品の添付文書に従ってください。
12. 高圧酸素室内での使用は、過注入、製品破損を生じる恐れがありますので避けてください。
13. 注入ポート付近、エアベントフィルター、コネクターには有機溶剤（アルコール等）が付着しないようにしてください。破損の原因になります。
14. 薬液充填後は注入ポートにキャップを必ず被せてください。
15. 液漏れ、液が流出しないなど、不具合が認められたものは使用を中止してください。
16. 本製品の表示流量は生理食塩水を用い、室温（23℃）で設定しています。薬液の濃度、粘度、温度等により流量は変化しますのでご注意ください。
17. 本製品の規定容量は100mL又は200mLです。本製品の規定容量より多く充填した場合、規定流量より低い流量で注入され、規定容量より少なく充填した場合、規定流量より高い流量で注入されますのでご注意ください。
18. 接続される患者側回路の長さ、内径、挿入部位等が流量に影響を与える場合がありますのでご注意ください。
19. 本製品に薬液を充填した後は速やかに注入を開始してください。薬液を充填したまま長時間放置すると流量に影響を与える場合がありますのでご注意ください。
20. 本製品は落下等の衝撃により破損の恐れがありますので大切にお取り扱いください。
21. 本製品を保管する場合には次の事項にご注意ください。
    - 水のかからない場所に保管してください。
    - 温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、イオウ分等を含んだ空気等により悪影響の生じる恐れのない場所に保管してください。
    - 振動、衝撃等、本製品の安定状態にご注意ください。
    - 化学薬品のそばやガスの発生するような場所に保管しないでください。
22. 結晶化する可能性がある薬剤を使用する際は、正常に注入が行われているかどうかを定期的に確認してください。輸液経路が閉塞されることがあります。

製造販売業者
大研医器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

2011/10〈社内管理番号：0280451301〉

クーデック® A BRAND OF DAIKEN MEDICAL COOPDECH

高度管理医療機器
一般的名称：加圧式医薬品注入器
医療機器承認番号：21400BZZ00497000
販売名：クーデックバルーンジェクター

# 取扱説明書

**携帯型ディスポーザブル注入ポンプ**

# クーデック®バルーンジェクター®
# 100mL/200mL [化学療法]

この度は、クーデックバルーンジェクターをお買い上げ頂き、
誠に有難うございます。
本製品を使用する際には、必ずこの取扱説明書と添付文書をお読み頂き、
お取り扱いくださいますようお願い致します。

**[製品構成・各部名称]**

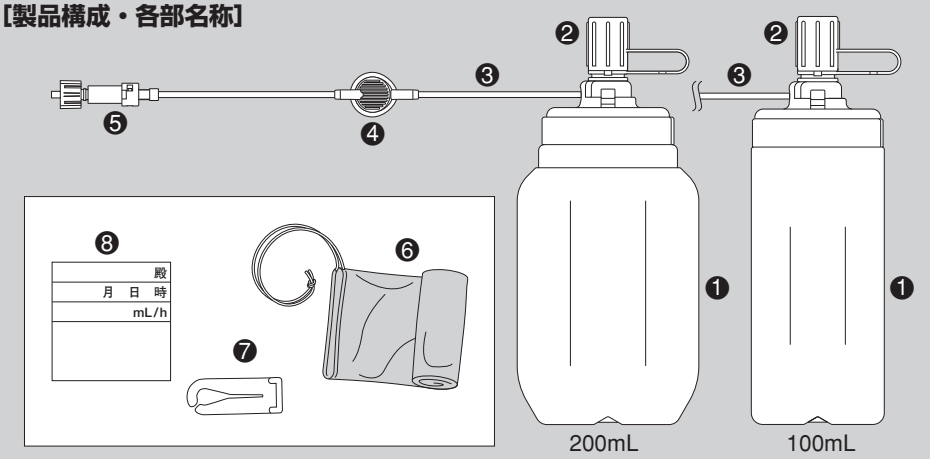


❶ バルーンジェクター本体　❹ エアベントフィルター　❼ スライドクランプ
❷ 注入ポート　❺ モノフロー　❽ 記名ラベル
❸ 延長チューブ　❻ キャリングバック

医療社会を未来する——
大研医器株式会社

## [ご使用方法]

### 1 薬液を充填します。

1. 滅菌包装からクーデックバルーンジェクターを取り出します。
2. 注入ポートのキャップをねじりながら外します。(図-1)
3. シリンジに薬液を充填し、注入ポートにシリンジ先端を確実に差し込み、 ゆっくりと注入します。

⚠ 注意
※注入にはルアー式シリンジをおすすめします。
※シリンジのルアーロックの構造がメーカーによって若干異なっています。一部の製品は、バルーンジェクター本体の「注入ポート」に深く入り過ぎて、反回転しただけではロックが解除できないことがあります。気が付かずにシリンジを引抜いた場合、「注入ポート」が外れることがあります。
※充填に使用するシリンジには注射針を使用しないでください。
※薬液の充填操作は無菌的に行ってください。
※投与する薬液のお取り扱いは、該当する医薬品の添付文書に従ってください。
※薬液の濃度、粘性、温度などにより流量は変化します。

4. 薬液の注入が終了した後、バルーンジェクター本体からシリンジをねじりながら取り外します。
5. 注入ポートのキャップを台座の凹凸を合わせて、しっかりと被せてください。

Memo
※本製品は注入ポートより薬液が取り出せない構造になっています。

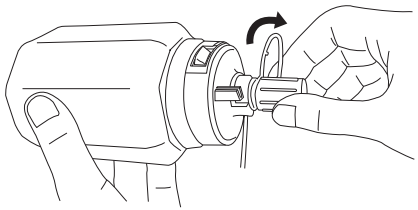

(図-1)

### 2 カテーテルに接続します。

1. モノフロー先端より薬液が出てくることを確認します。
2. モノフロー先端を患者側回路に接続します。

⚠ 注意
※接続する患者側回路の添付文書をよくお読みください。

3. 必要に応じキャリングバッグに入れます。

### 3 使用後の処理。

1. バルーンジェクターの取り外し後は、付属のスライドクランプで根元を閉塞します。(図-2)
2. モノフローを注入ポートにねじ込み、薬液の漏れを防止してしてください。(図-3)

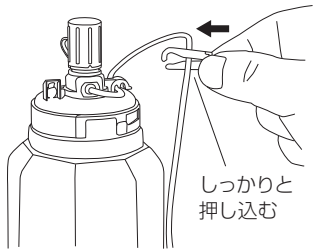


(図-2)

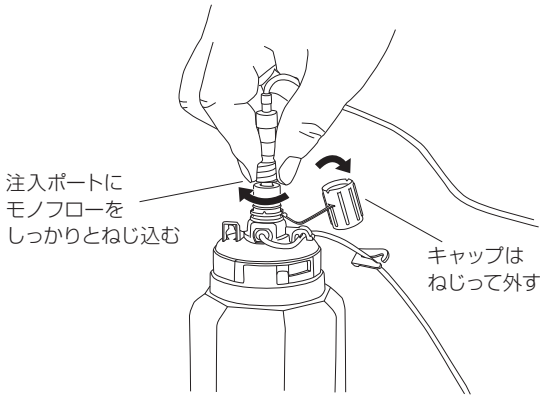


(図-3)